Medidor de PH

BIOTEMPAK®

MEDIDOR DE PH

Calibración de un solo toque al activarse; el medidor realiza una calibración de un solo punto en las memorias intermedias de pH 7, 4 o 10.

Con su diseño aprueba de agua y potabilidad, sin duda el medidor de PH Senz es el más conveniente y confiable para que los técnicos realicen comprobaciones y pruebas de agua, ya que su efectividad no tiene comparación con cualquier probador de bolsillo.

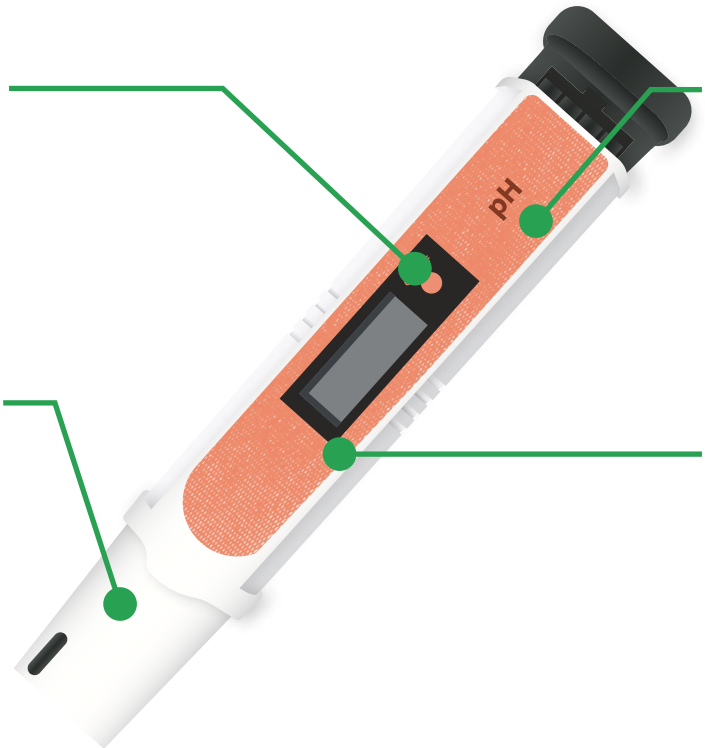

Calibración
El equipo tiene calibración de un solo toque al activarse.

Precisión
Control eficiente de las enfermedades post cosecha mientras evita o reduce el uso de agroquímicos sintéticos.

Resistencia a Golpes
Gracias a su sensor de vidrio reforzado, puede resistir caídas cortas y golpes leves accidentales

A prueba de Agua
Con su diseño a prueba de agua combinado con su portabilidad lo hacen la mejor opción

Con su incomparable sensor de vidrio reforzado puede resistir caídas cortas y golpes leves accidentales, ademas, nunca pasa por alto un punto de calibración con la función de detección del punto final.

biotempak.com
01 800 112 46 83
contacto@biotempak.com

Medidor de PH

BIOTEMPAK®

ESPECIFICACIONES

Rango	0.0 hasta 14pH
Resolución	0.1 pH
Precisión	+-0.2 pH
Batería	4 x 1.5 V pila de botón
Temperatura de operación	de 0º hasta 50ºC
Tamaño	147 x 32 x 15 mm

CÓMO HACER LA MEDICIÓN

1. Pare encender la unidad, presiona el boton"ON/OFF" que se encuentra en la parte frontal del dispositivo.
2. Sacuda el dispositivo de manera rápida, como si lo fuera a hacer con un termómetro de mercurio.
3. Sumerja el dispositivo en la solución de muestra hasta el punto de inmersión indicado.
4. Sacuda el sensor dentro de la solución de muestra para eliminar burbujas y espera por la lectura.
5. Si el sensor se encuentra seco la lectura será más lenta. Sumerja el sensor en un vaso de agua o de preferencia solución para calibración pH7, esto durante un periodo de 1 a 2 hrs antes de hacer otra prueba.
6. Oprime nuevamente el boton "ON/OFF", esto apagara el dispositivo.

CALIBRACIÓN

Su dispositivo está calibrado desde fabrica, se recomienda re-calibrar regularmente para mantener la precisión deseada para el dispositivo.

1. Use la disolución reguladora pH 7 para calibración.
2. Sacuda el dispositivo de manera rápida, como si lo fuera a hacer con un termómetro de mercurio antes de cada calibración.
3. Vierta la solución reguladora pH 7 en un recipiente pequeño y sumerja el dispositivo hasta que se desborde.
4. Sacuda el sensor dentro de la solución de muestra para eliminar burbujas y espere a que se estabilice la lectura.
5. Usando el desatornillador pequeño incluido, localice el "Trimmer de calibración"en la parte de atrás del dispositivo y ajuste el display hasta que lea 7.0.
6. Enjuague el dispositivo con agua.
7. Calibración completada.

biotempak.com
01 800 112 46 83
contacto@biotempak.com